


APSTIPRINU	Valsts asinsdonoru centra direktore	E.Pole	(personiskais paraksts*)	24.03.2022
------------	-------------------------------------	--------	--------------------------	------------

Produkta nosaukums	Produkta kods
Svaigi saldēta plazma iegūta no pilnasinīm	E4052
Svaigi saldēta plazma iegūta plazmaferēzē	E4701, E4693, E4697 E4689
Svaigi saldēta plazma iegūta aferēzē	E3893

Parametrs	Prasība
Laboratoriskie izmeklējumi:	
ABO piederība	Identificēta
HIV AV+Ag	Negatīvs
HCV AV	Negatīvs
HBs Ag	Negatīvs
T.Pallidum AV	Negatīvs
HCV RNS	Negatīvs
HIV RNS	Negatīvs
HBV DNS	Negatīvs
Antieritrocitārās antivielas	Negatīvs
Kvalitātes kontroles rādītāji	Atbilst "Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components" (aktuālā versija) prasībām
Makroskopiskās novērtēšanas kritēriji	Maisam ar SSP nav redzamas bojājuma pazīmes, pēc atkausēšanas mais ar plazmu ir hermētisks Plazmas krāsa ir atbilstoša (dzidra, nav duļķaina, nav pārslojuma, nav redzams eritrocītu piejaukums, nav izteiktas hilozes pazīmes) SSP deva ir identificējama
Fināla etiķete	Atbilst ISBT 128 standartam (sk. 1.att.)

Uzglabāšanas temperatūra	Transportēšanas temperatūra
<-25°C	<-25°C (ja transportēšanas laikā temperatūra sasniedz -18°C, tad SSP derīguma termiņš jānomaina uz 3 mēnešiem)

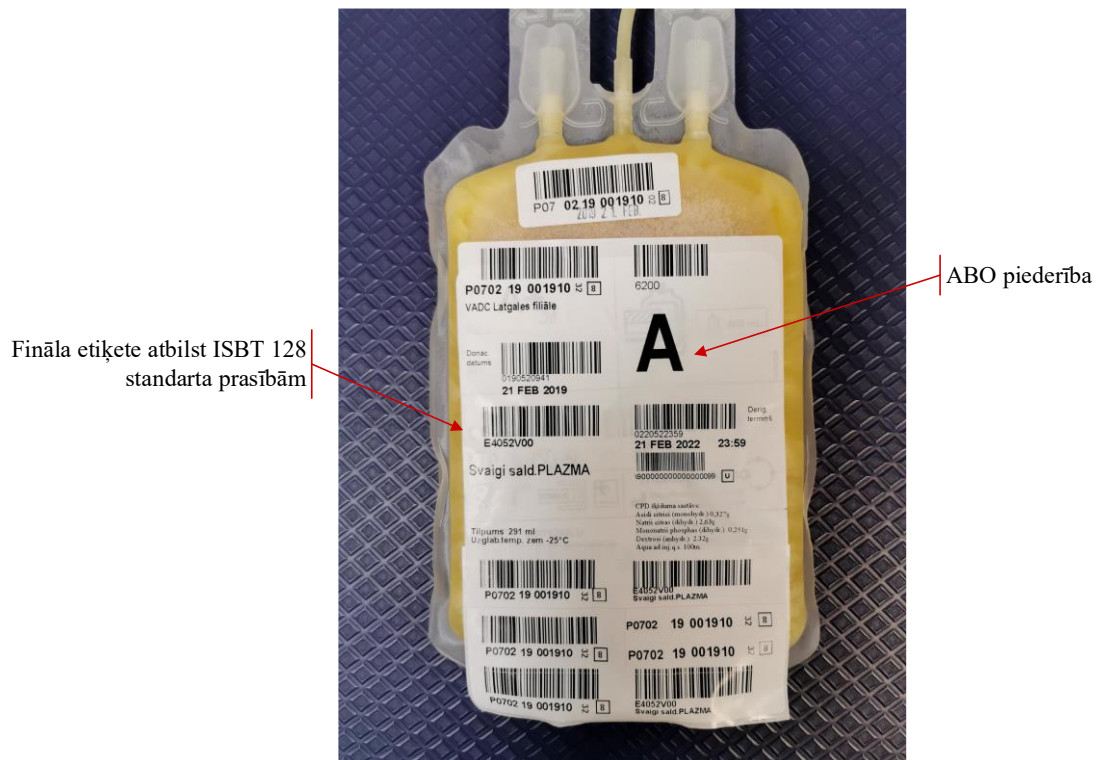

1.att. Pārliešanai derīgas SSP iegūta no pilnasinīm devas piemērs

Izstrādāja:

Amats	V.Uzvārds	Paraksts	Datums
Transfuzioloģiskā departamenta direktore	N.Kanta	(personiskais paraksts*)	24.03.2022

Saskaņoja:

Amats	V.Uzvārds	Paraksts	Datums
Kvalitātes un risku vadības departamenta Eksperts Asins dienestā	E.Kluce	(personiskais paraksts*)	24.03.2022