
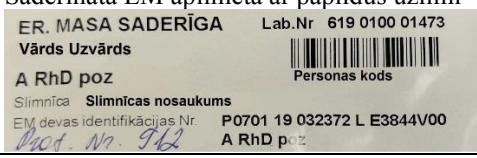
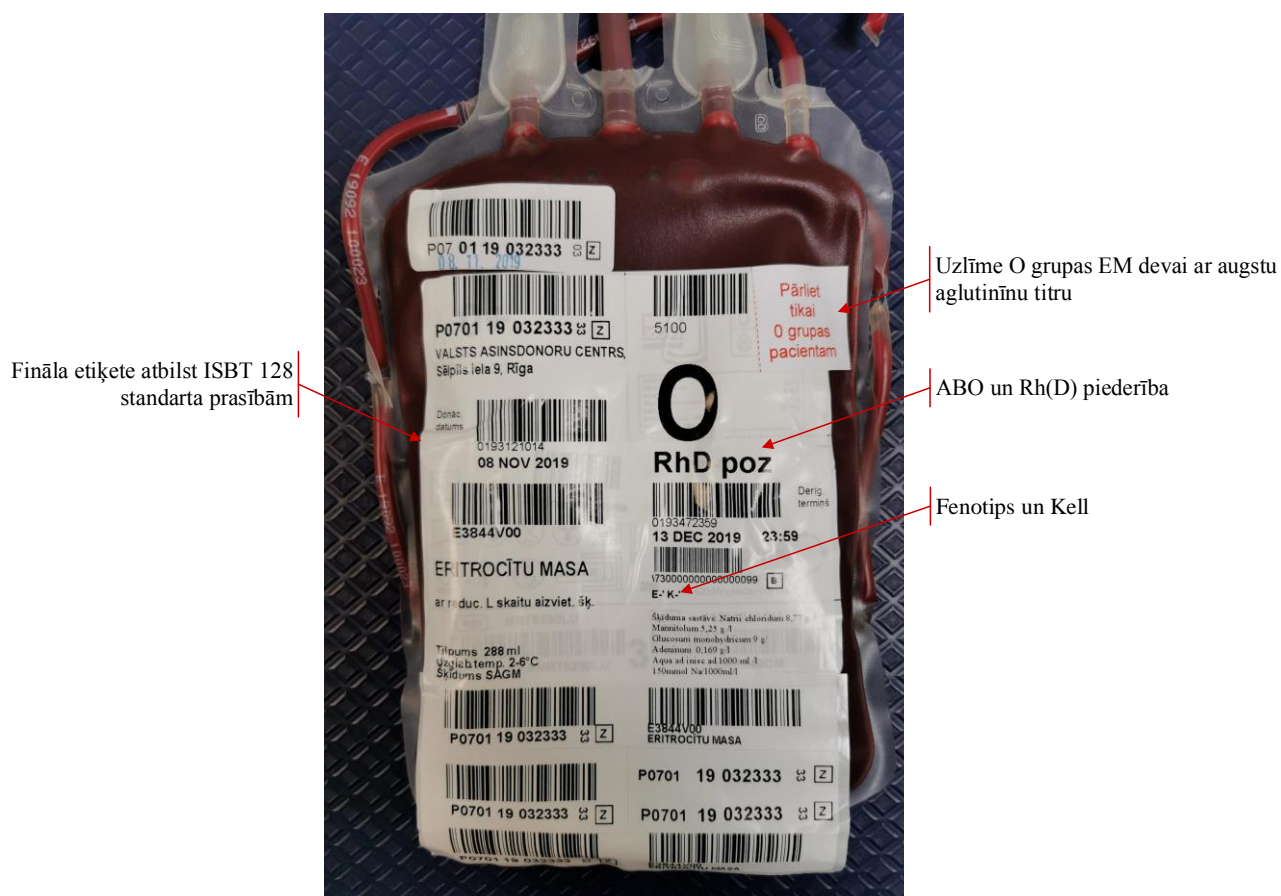


## Pārļiešanai derīgas eritrocītu masas (EM) specifikācija

Produkta nosaukums	Produkta kods
Eritrocītu masa bez trombocītu – leikocītu slāņa aizvietojoša šķīdumā	E3844
Apstarota eritrocītu masa bez trombocītu – leikocītu slāņa aizvietojoša šķīdumā	E3845
Atmazzgāta eritrocītu masa	E3851
Atmazzgāta apstarota eritrocītu masa	E3852
Filtrēta eritrocītu masa bez trombocītu – leikocītu slāņa aizvietojoša šķīdumā	E5259
Filtrēta un apstarota eritrocītu masa bez trombocītu – leikocītu slāņa aizvietojoša šķīdumā	E5261

Parametrs	Prasība	Produkta kods
<b>Laboratoriskie izmeklējumi:</b>		
ABO, Rh(D) piederība	Identificēta	E3844, E3845, E3851, E3852, E5259, E5261
HIV AV+Ag	Negatīvs	E3844, E3845, E3851, E3852, E5259, E5261
HCV AV	Negatīvs	E3844, E3845, E3851, E3852, E5259, E5261
HBs Ag	Negatīvs	E3844, E3845, E3851, E3852, E5259, E5261
T.Pallidum AV	Negatīvs	E3844, E3845, E3851, E3852, E5259, E5261
HCV RNS	Negatīvs	E3844, E3845, E3851, E3852, E5259, E5261
HIV RNS	Negatīvs	E3844, E3845, E3851, E3852, E5259, E5261
HBV DNS	Negatīvs	E3844, E3845, E3851, E3852, E5259, E5261
Antieritrocitārās antivielas	Negatīvs	E3844, E3845, E3851, E3852, E5259, E5261
Fenotips	Identificēts	E3844, E3845, E3851, E3852, E5259, E5261
Kell	Identificēts: - Negatīvs – norādīts uz fināla etiķetes; - Pozitīvs - norādīts uz fināla etiķetes un aplīmēts ar papildus uzlīmi  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p><b>Kell – pozitīvu EM izmanto:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kell – pozitīviem recipientiem;</li> <li>- Vīriešiem;</li> <li>- Sievietēm nereproduktīvā vecumā (menopauzē).</li> </ul> <p><b>Nedrīkst pārliet:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Intrauterīni</li> <li>- Neonatoloģijas un pediatrijas praksē;</li> <li>- Sievietēm reproduktīvā vecumā;</li> <li>- Aloimunizētiem recipientiem.</li> </ul> </div>	E3844, E3845, E3851, E3852, E5259, E5261
Augsts aglutinīnu titrs (tikai O grupas EM)	Noteikts Gadījumā, ja aglutinīnu titrs > 256, EM aplīmē ar papildus uzlīmi <b>„Pārliet tikai O grupas pacientam”</b> (sk. 1.att.)	E3844, E3845, E3851, E3852, E5259, E5261
Saderības testi pēc ārstniecības iestādes pieprasījuma	Saderināta EM aplīmēta ar papildus uzlīmi 	E3844, E3845, E3851, E3852, E5259, E5261
<b>Kvalitātes kontroles rādītāji</b>	Atbilst “Guide to the preparation, use and quality	E3844, E3845, E3851,

Parametrs	Prasība	Produkta kods
	assurance of blood components” (aktuālā versija) prasībām	E3852, E5259, E5261
<b>Makroskopiskās novērtēšanas kritēriji</b>	Maiss ar EM ir hermētisks EM krāsa ir atbilstoša (nav hemolīzes pazīmes) EM nav recekļu EM deva ir identificējama	E3844, E3845, E3851, E3852, E5259, E5261
<b>Fināla etiķete</b>	Atbilst ISBT 128 standartam (sk. 1.att.)	E3844, E3845, E3851, E3852, E5259, E5261
<b>Citi parametri:</b> Apstarošana	EM deva ir aplīmēta ar apstarošanas indikatoru, kas apliecina, ka EM saņēma apstarošanas devu no 25 līdz 50 Gray	E3845, E3852, E5261

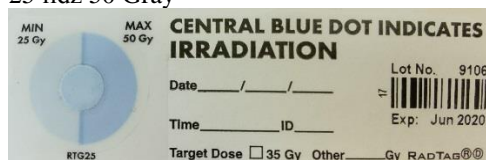

1.att. Pārļiešanai derīgas EM devas piemērs