


	Informācija klientiem Pārļiešanai derīgas eritrocītu masas (EM) specifikācija			Nr. I-009 Lpp.1 no 2
	APSTIPRINU	Valsts asinsdonoru centra direktore	E.Pole	(personiskais paraksts*)

Produkta nosaukums	Produkta kods
Eritrocītu masa filtrēta, atmazgāta	E3851
Eritrocītu masa filtrēta, atmazgāta, apstarota	E3852
Eritrocītu masa filtrēta	E5259
Eritrocītu masa filtrēta, apstarota	E5261

Parametrs	Prasība
Laboratoriskie izmeklējumi:	
ABO, Rh(D) piederība	Identificēta
HIV AV+Ag	Negatīvs
HCV AV	Negatīvs
HBs Ag	Negatīvs
T.Pallidum AV	Negatīvs
HCV RNS	Negatīvs
HIV RNS	Negatīvs
HBV DNS	Negatīvs
Antieritrocitārās antivielas	Negatīvs
Fenotips	Identificēts
Kell	Identificēts: - Negatīvs – norādīts uz fināla etiķetes; - Pozitīvs - norādīts uz fināla etiķetes un aplīmēts ar papildus uzlīmi <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>Kell – pozitīvu EM izmanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kell – pozitīviem recipientiem; - Vīriešiem; - Sievietēm nereproduktīvā vecumā (menopauzē). <p>Nedrīkst pārliet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intrauterīni - Neonatoloģijas un pediatrijas praksē; - Sievietēm reproduktīvā vecumā; - Aloimunizētiem recipientiem. </div>
Augsts aglutinīnu titrs (tikai O grupas EM)	Noteikts Gadījumā, ja aglutinīnu titrs > 256, EM aplīmē ar papildus uzlīmi „Pārliet tikai O grupas pacientam” (sk. 1.att.)
Saderības testi pēc ārstniecības iestādes pieprasījuma	Saderināta EM aplīmēta ar papildus uzlīmi 
Kvalitātes kontroles rādītāji	Atbilst “Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components” (aktuālā versija) prasībām
Makroskopiskās novērtēšanas kritēriji	Maiss ar EM ir hermētisks EM krāsa ir atbilstoša (nav hemolīzes pazīmes) EM nav recekļu EM deva ir identificējama
Fināla etiķete	Atbilst ISBT 128 standartam (sk. 1.att.)
Citi parametri: Apstarošana	EM deva ir aplīmēta ar apstarošanas indikatoru, kas apliecina, ka EM saņēma apstarošanas devu no 25 līdz 50 Gray 

Uzglabāšanas temperatūra	Transportēšanas temperatūra
+2°C līdz +6°C	+2°C līdz +6°C (pieļaujamās temperatūras novirzes transportēšanas laikā robežās no +1°C līdz +10°C)

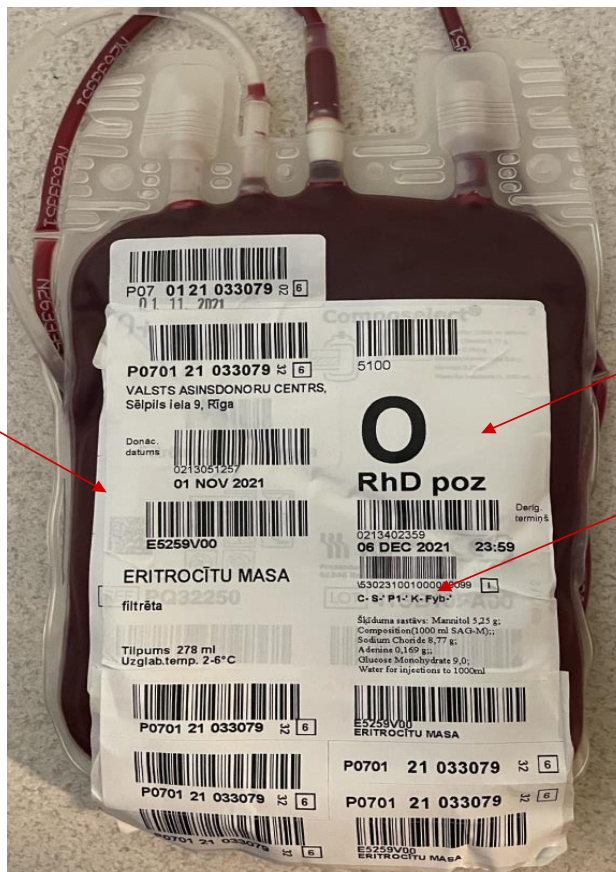

Fināla etiķete atbilst ISBT 128 standarta prasībām

ABO un Rh(D) piederība

Fenotips un Kell

1.att. Pārliešanai derīgas EM filtrētas devas piemērs

Izstrādāja:

Amats	V.Uzvārds	Paraksts	Datums
Transfuzioloģiskā departamenta direktore	N.Kanta	(personiskais paraksts*)	24.03.2022

Saskaņoja:

Amats	V.Uzvārds	Paraksts	Datums
Kvalitātes un risku vadības departamenta Eksperts Asins dienestā	E.Kluce	(personiskais paraksts*)	24.03.2022